


2

La perfusion fonctionne normalement

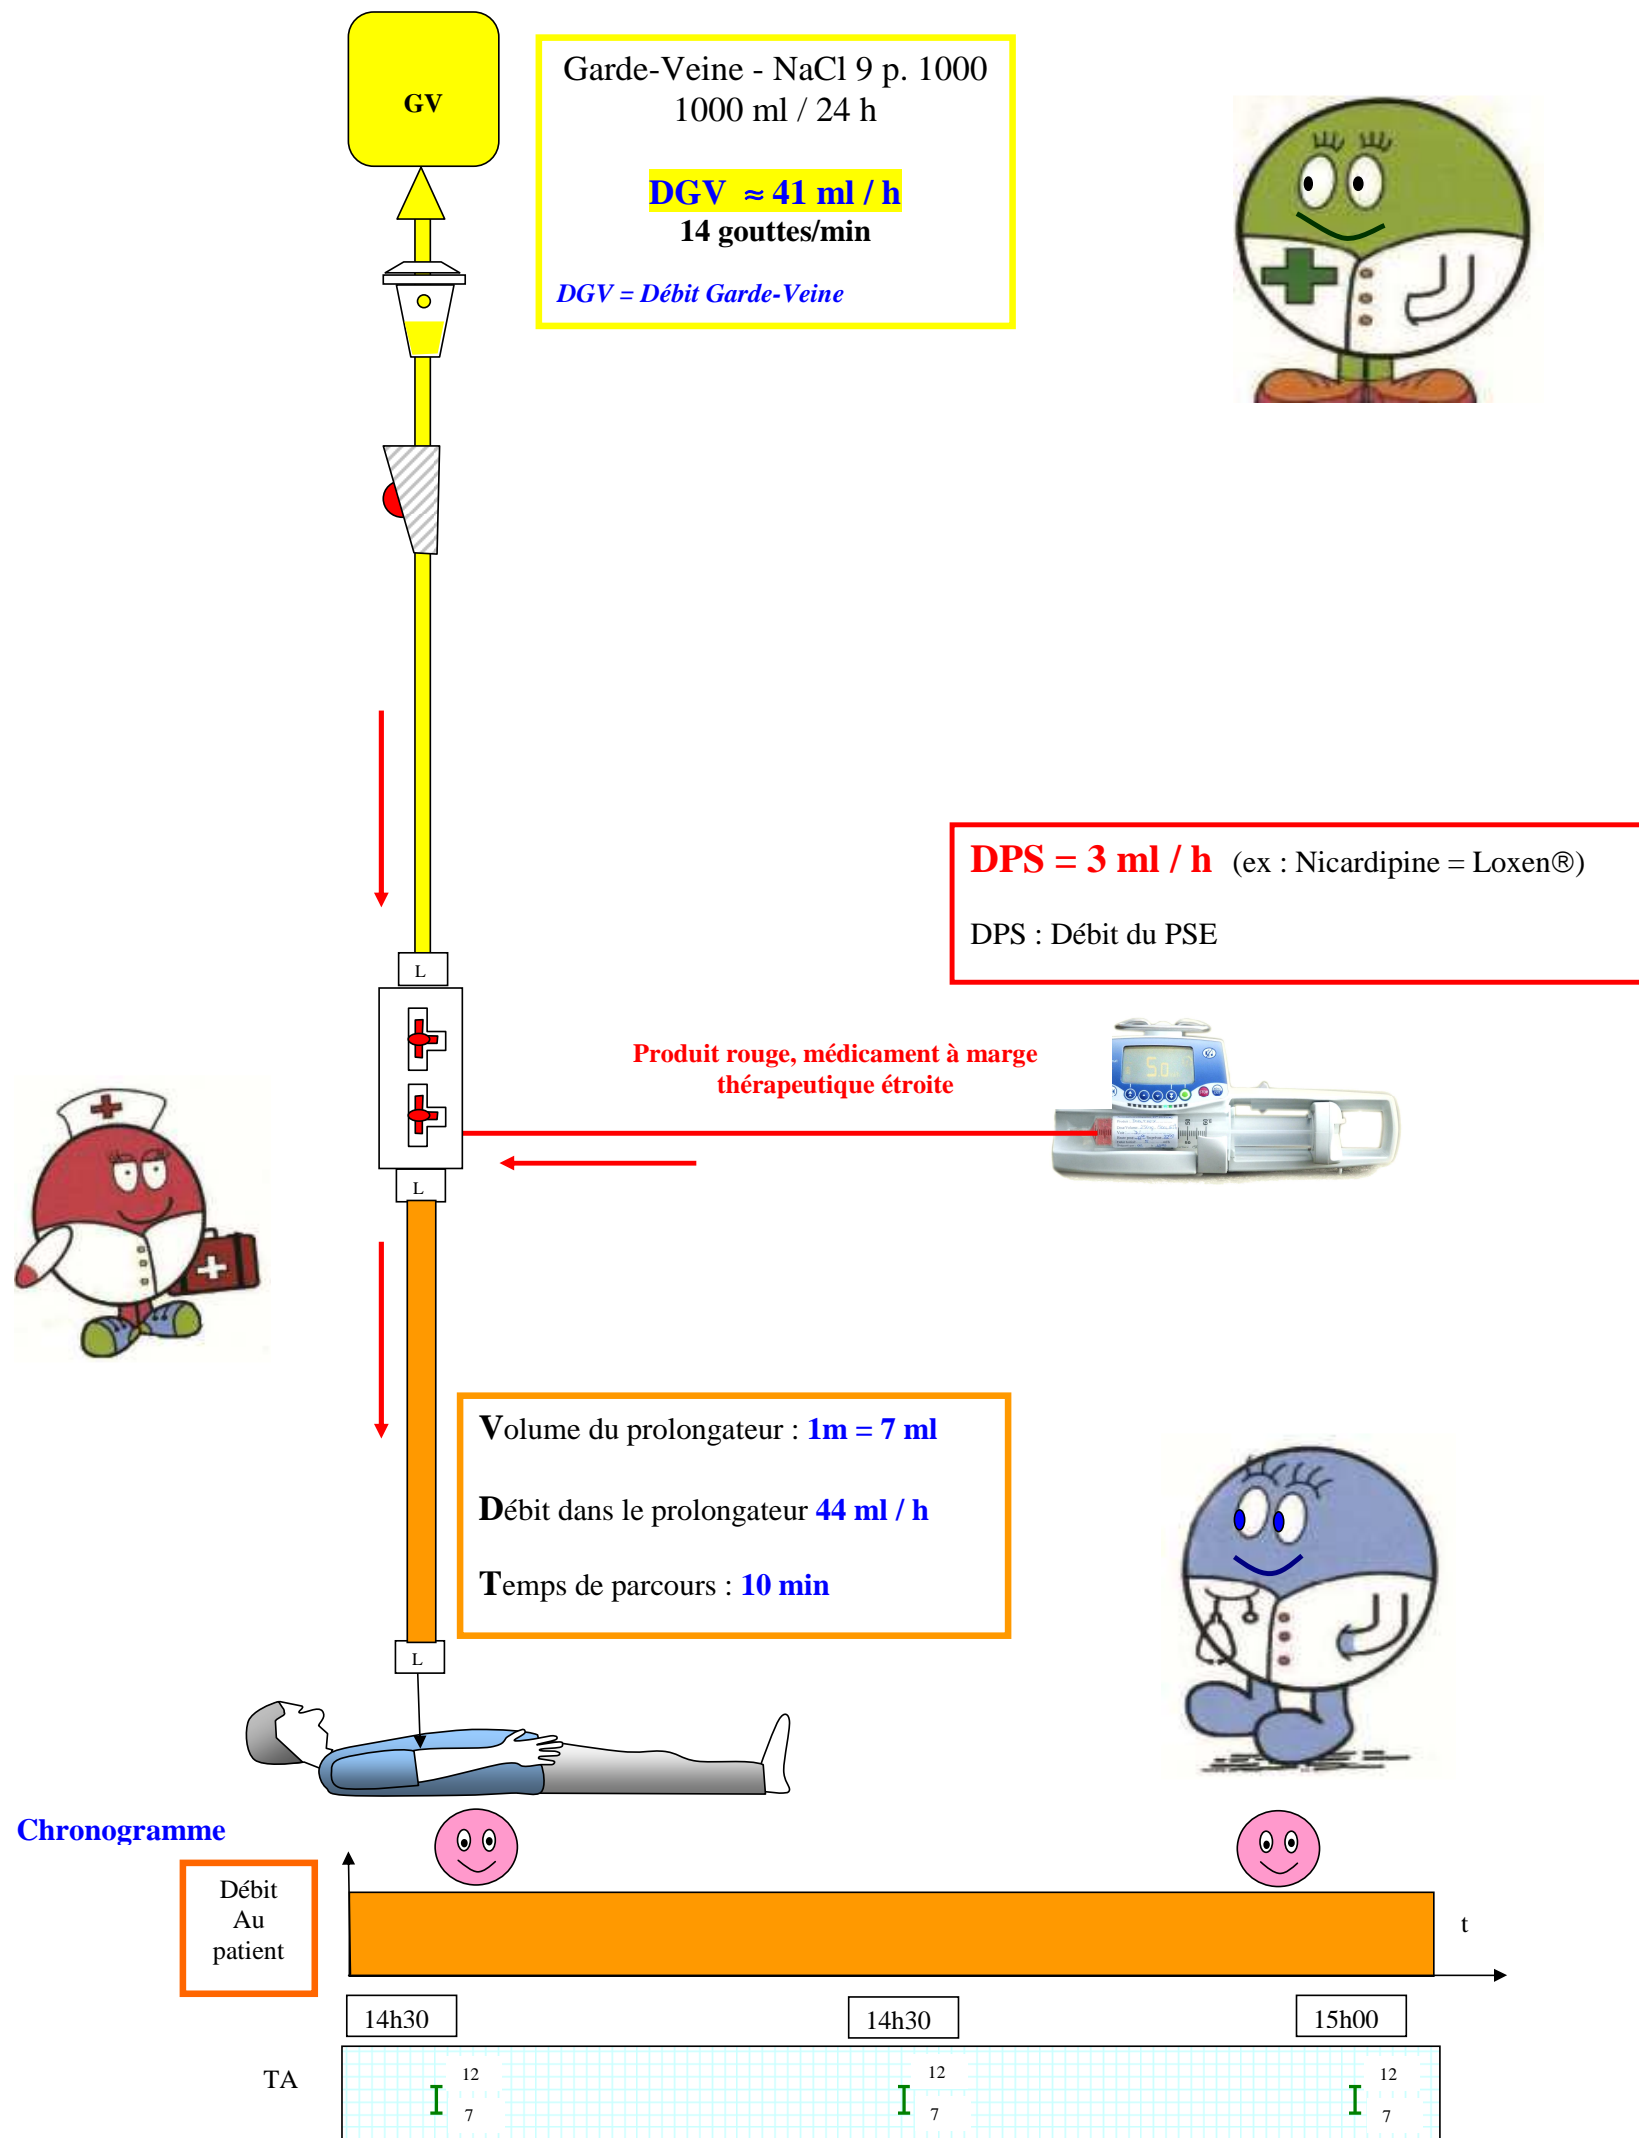

Quand le principe actif a parcouru la totalité du prolongateur "tronc commun" (10 minutes dans notre exemple), il est dilué par le sérum physiologique garde-veine

Il est **administré au patient au débit de réglage du PSE** (3 mg / h dans notre exemple) .

Tout va bien ...